



# WELL-2

Reliable endoscope washer  
& disinfector

## Quick 소독 기능

Quick 소독으로 보다 간편하고 빠르게  
내시경 소독이 가능합니다.

## 대용량 챔버로 한번에 2개 내시경 소독

2개의 내시경 동시 세척 가능한 모델로,  
세척시간을 절약합니다.

## 소독력 확보를 위한 안전장치


역류 체크 밸브로 소독제의 역류 및 희석을 방지하고,  
소독제 필터 사용으로 내시경 채널에 이물질의 유입을 차단합니다.



## WELL-2 제품정보

내시경수량	세척방법	화면표시방법	디지털/ 방수체크기능	소독제필터
2개	360° 회전분사	FnD	✓	✓
소독제사용 횟수기록	알코올기능	세정제기능	에어건	물통장착
✓	✓	✓	✓	✓

## WELL-2 제품특징

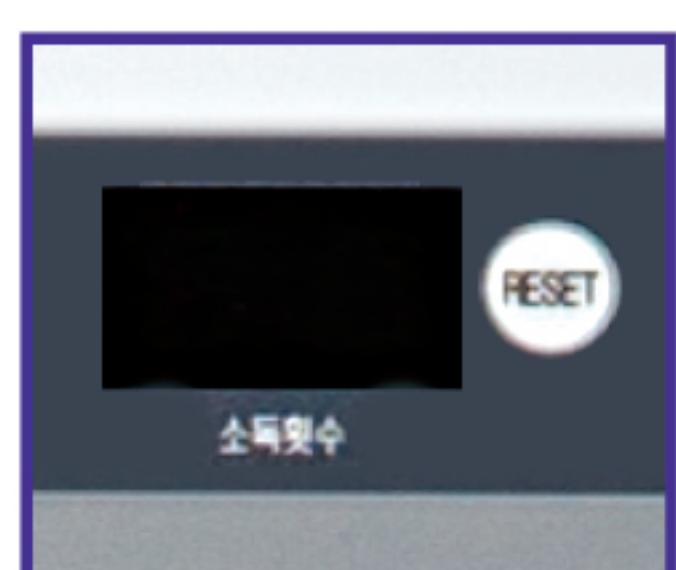

### 소독 횟수 카운트

사용자가 소독액을 몇 번이나 사용했는지 확인 가능하여 교환주기 판별에 용이




### 세정제&알코올 기능

소독 전 세정을 통해 소독력 향상  
세척·소독 완료 후 알코올로  
내시경 채널 내부 건조 및 코팅막 생성



### 물통 장착으로 세척기능 향상

공급되는 수도의 압력과 관계없이 순환 펌프를 이용해 일정 압력으로 물을 분사하여 세척 진행

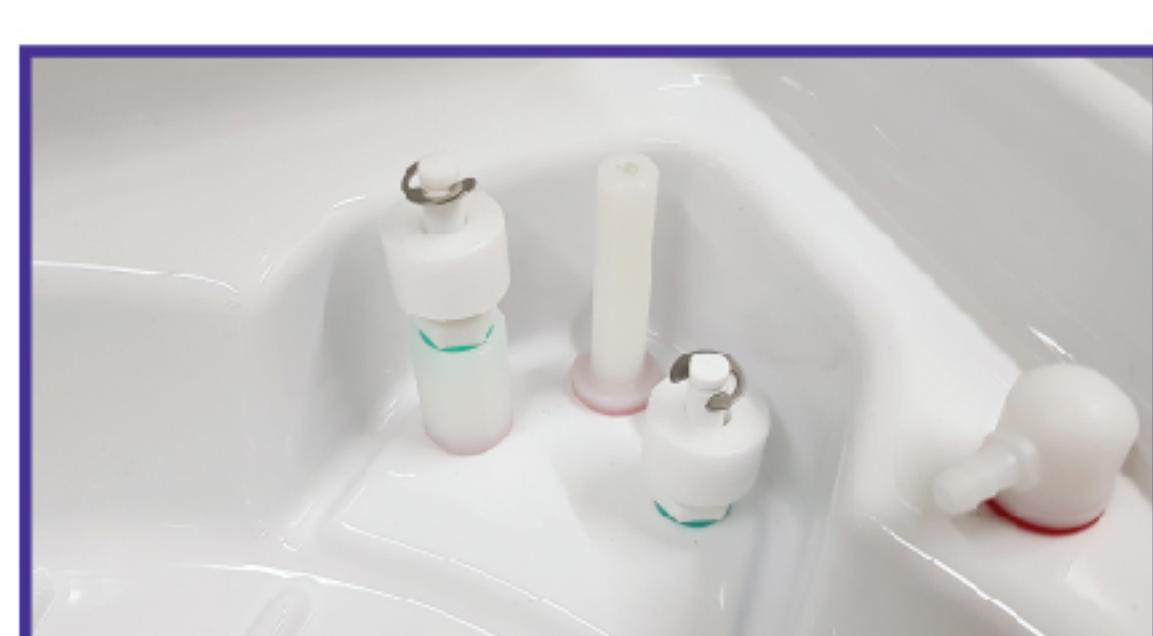

### 넘침방지 시스템

소독제로부터 안전하게 사용 가능한  
넘침방지 시스템



### 넓은 챔버

스콥 2개가 동시에 들어가는 넓은 챔버로  
소독시간 단축



## WELL-2 사용방법 및 순서




### Manual

Scope Setting ▶ Leakage test (Waterproof) ▶

### Automatic

Air ▶ Detergent ▶ Air ▶ Disinfecting ▶ Air ▶ Rinse ▶ Washing ▶ Air ▶ Alcohol

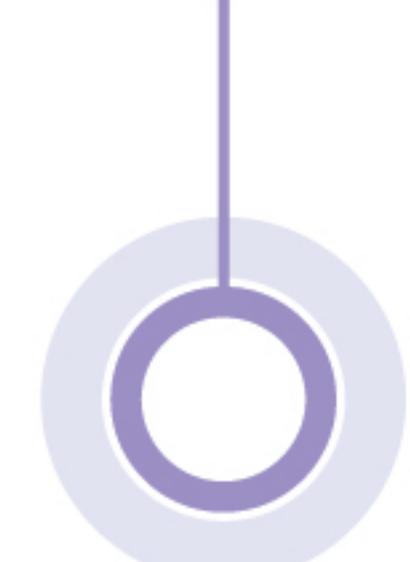

※ 세척 및 소독시간은 사용자에 의해 변경 가능

### Quick 소독

Air ▶ Disinfecting ▶ Air ▶ Rinse ▶ Washing ▶ Air ▶ Alcohol

## WELL-2 제품사양

내시경 누수 테스터	디지털 에어 모드 & 방수 모드
시간설정 (사용자 설정)	1) 세정시간 : 10초~90초 2) 소독시간 : 10초~99분 90초 3) 알코올시간 : 10초(고정)
펌프	누수 체크 펌프, 에어 펌프, 배수 펌프, 소독액 펌프
챔버용량(선택)	약 16L (소독액 탱크 : 18L)
탱크용량	1) 물 : 9L 2) 알코올 : 1L 3) 세정제 : 1L
컨넥터	방수 테스터용 컨넥터 1개 세척용 컨넥터 6개
배출	소독액 잔량 배출호스 1개
전압/주파수	AC 220~240V, 60Hz
소비전력	1500W
크기(WxDxH)	696 x 656 x 1015 mm (커버 닫힘) 696 x 656 x 1445 mm (커버 열림)
중량	81kg



Huons Medicare

(주)휴온스메디케어

본사 : 부산광역시 강서구 녹산산단165로 22 Tel. 051-831-1030 Fax. 051-831-1040

공장 : 인천광역시 부평구 안남로 418번길 27, C동 401호

제품문의 : [www.huonsmedicare.com](http://www.huonsmedicare.com) Tel. 070-7410-8991